


IA: CALIBRADOR DE INDICADORES

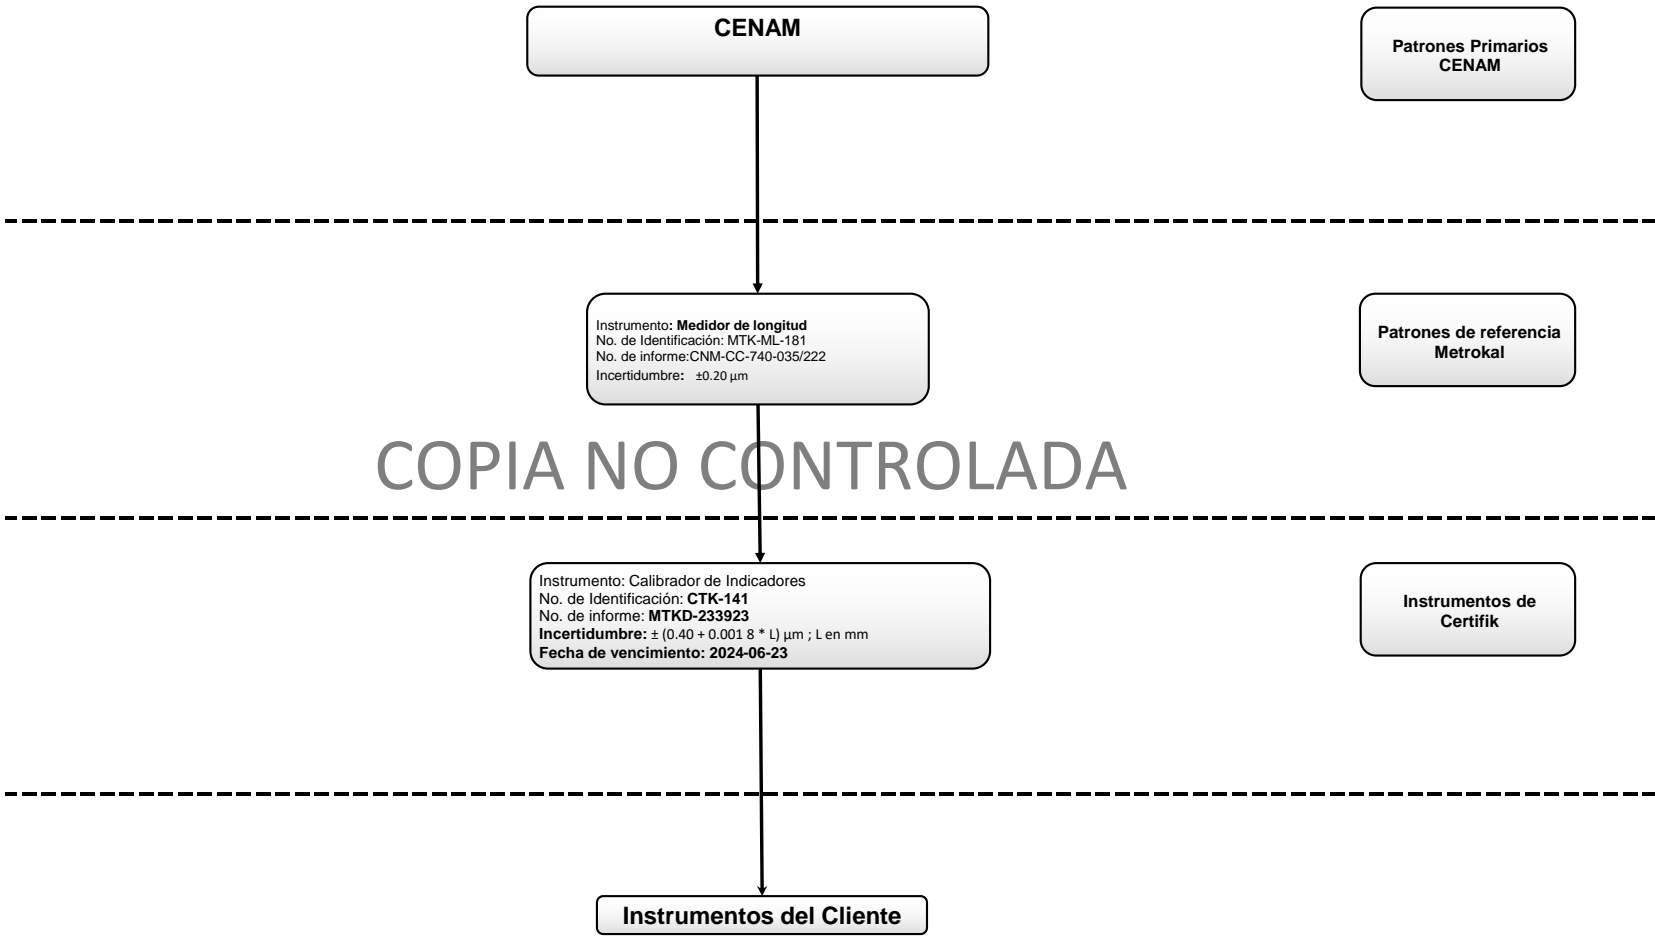

CENAM

Patrones Primarios
CENAM

Instrumento: **Medidor de longitud**
 No. de Identificación: **MTK-ML-181**
 No. de informe: **CNM-CC-740-035/222**
 Incertidumbre: $\pm 0.20 \mu\text{m}$

Patrones de referencia
Metrokal

Instrumento: **Calibrador de Indicadores**
 No. de Identificación: **CTK-141**
 No. de informe: **MTKD-233923**
 Incertidumbre: $\pm (0.40 + 0.001 8 * L) \mu\text{m}$; L en mm
 Fecha de vencimiento: **2024-06-23**

Instrumentos de
Certifik

Instrumentos del Cliente